NIPUMP TOOLBOX 001

DIVISIÓN HOSPITALARIA

¿CÓMO INSTALAR EL SET?

PASO	IMAGEN	ACCIÓN
1		Encender el equipo pulsando el botón ON/OFF
2		Presionar el botón OPEN / APERTURA para abrir el frontal de la bomba
3		Completar la apertura halándolo suavemente
4	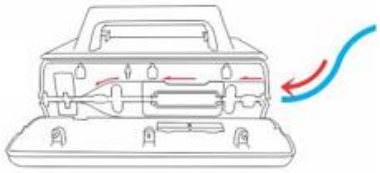	Pulsar el botón amarillo interno del motor ANTIFLUJO LIBRE para que la guía de instalación se encuentre libre de obstáculos
5		Ocluir el set de infusión purgado con la NiproKey (llave verde)
6	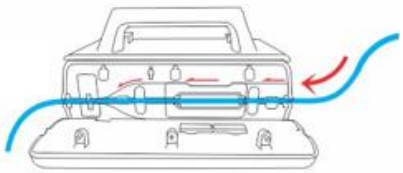	Posicionar el set de derecha a izquierda siguiendo las señales grabadas
7		Insertar la parte más delgada de la NiproKey en la ranura ubicada a la izquierda
8	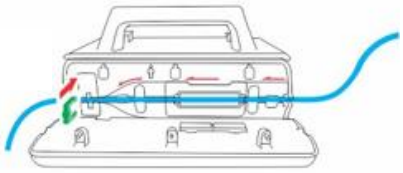	Asegúrese de que el set esté instalado correctamente en la ubicación de los sensores de burbujas de aire y de oclusión
9		Realizar el cierre del equipo afrontando las dos partes con las manos

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS

División Hospitalaria

NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA

¿CÓMO DESINSTALAR EL SET?

PASO	IMAGEN	ACCIÓN
1		Obturar manualmente el Clamp de Robert para causar oclusión total del fluido
2		Mantener presionado el botón OPEN / APERTURA para abrir el frontal de la bomba
3		Pulsar botón amarillo interno ANTIFLUJO LIBRE
4		Halar el tubo suavemente hasta que sea liberado por completo
5		Realizar el cierre del equipo afrontando las dos partes con las manos
6		Verificar que no exista escape de líquido
7		Apagar el equipo pulsando el botón ON/OFF

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS

División Hospitalaria

NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA